


MŰKÖDTETÉS:

- Csatlakoztassa a mellékelt 12 VDC hálózati adaptert a mérőhöz és a hálózathoz.
- Győződjön meg arról, hogy a mérőt kalibrálta, mielőtt bármilyen mérést végez (lásd a Kalibrálási eljárást).
- Merítse a vezetőképesség szonda hegyét (4 cm) a mintába.
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával.
- Várja meg a termikus egyensúly elérését, és a mérő elkezdi a folyamatos ellenőrzést.
- Állítsa a BELOW / ABOVE riasztás aktiváló kapcsolót a kívánt helyzetbe.
- Villogó riasztás jelzi, ha a mért EC vagy TDS érték alacsonyabb/magasabb, mint az alapjel (a BELOW / ABOVE kapcsolónak megfelelően). SETPOINT:
 - Az alapjel kiválasztható a központi elülső gomb kívánt értékre állításával.
 - Az MC310 választható tartománya 1,0-5,0 mS/cm.

Az MC410 és az MC410A választható tartománya 700 és 1900 ppm között van.

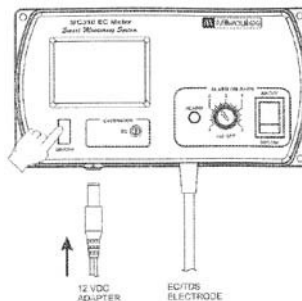

KALIBRÁLÁSI ELJÁRÁS:

- Tisztítsa meg a szondát alkohollal és hagyja megszáradni (ha alaposabb tisztításra van szükség, finom csiszolópapírral kefélje le a fémcsapokat, majd öblítse le vízzel).
- Nyisson ki egy tasak megfelelő vezetőképesség-kalibráló oldatot, és merítse be a szondát, ügyelve arra, hogy a fémtüskék teljesen elmerüljenek.

Használjon M10039-et (5,00 mS/cm) MC310, M10442 esetén

(1500 ppm) MC410 és M10032 (1382 ppm) MC410A esetén.

- Kapcsolja be a mérőt az ON/OFF gomb megnyomásával.
- Várja meg, amíg a leolvasott érték stabilizálódik a hőmérséklet-ingadozások miatt, majd állítsa be az EC/TDS kalibrációs trimmert az előlapon a mellékelt csavarhúzóval, amíg a kijelzőn megjelenik: "5,0" mS/cm MC310, "1500" ppm MC410 és "1380" " ppm az MC410A esetében.

A kalibrálás ezzel befejeződött, és a mérő készen áll a használatra.

A műszert legalább havonta egyszer, vagy a szoda cseréjekor újra kell kalibrálni.


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK:

M10039B 5,00 mS/cm kal. oldat, 20 ml-es tasak (25 db)

M10442B 1500 ppm kal. oldat, 20 ml-es tasak (25 db)

M10032B 1382 ppm kal. oldat, 20 ml-es tasak (25 db)

MA812/2 Vezetőképesség szonda 2 m kábellel



MC310 1,0-5,0 mS/cm

MC410, MC410A 100-1900 ppm

ALARM aktív, ha a mérték az alapjel alatt/felül van, a BELOW/BOVE kapcsolónak megfelelően

HŐMÉRSÉKLET KOMPENZÁCIÓ Automatikus, 0 és 50°C között

KÖRNYEZET 0-50°C; 95% relatív páratartalom max.

MA812/2 PROBE (tartozék)*

TÁPELLÁTÁS 12 VDC adapter (tartozék)

MÉRETEK 148,5 x 82,5 x 32 mm

SÚLY 180 g

VEZETŐKÉPESSÉG ÉS TDS MÉRŐK

MODELLEK: MC310, MC410, MC410A